


Vista frontal del Data Logger TempMate-S1 V2

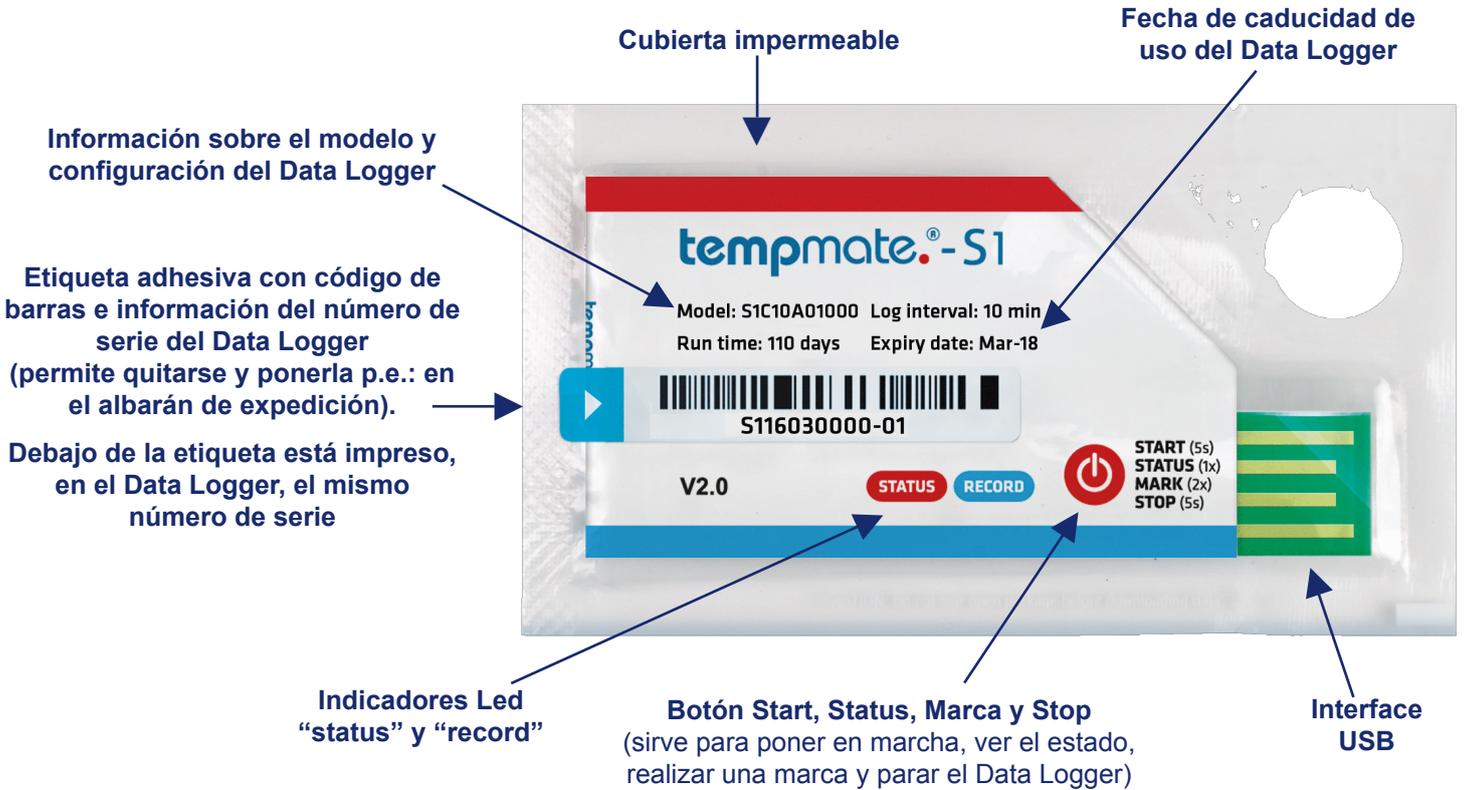

Vista posterior del Data Logger TempMate-S1 V2

Recordatorio de función del Data Logger

al presionar el botón Start / Stop 2 veces rápidamente


hace una marca en el registro en el momento que se realiza y parpadean 5 veces los dos indicadores leds "status" y "record"; si al presionar para hacer una marca se enciende en indicador "status" 5 veces nos indica que la función de marcas ha llegado a su límite

Nota de seguridad

Si al apretar el botón START el Led Record no parpadea 10 veces indicando la puesta en marcha correcta, por favor, no use el Data Logger

Recordatorio de función del Data Logger al mantener presionado el botón Start / Stop durante 5 segundos

cuando se pone en marcha el indicador led "record" (azul) parpadeará 5 veces cuando se para el indicador led "status" (rojo) parpadeará 5 veces

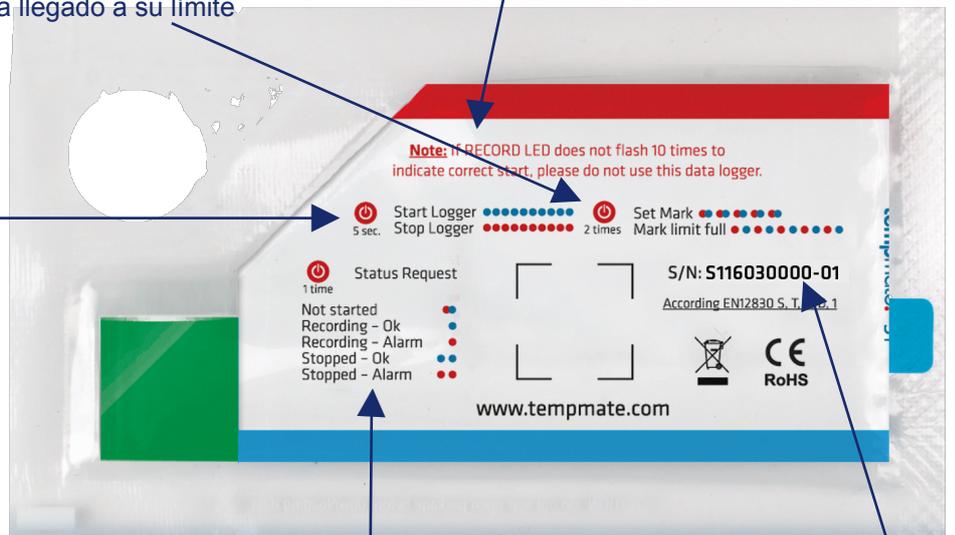

Recordatorio de función del Data Logger al presionar el botón Start / Stop 1 vez dependiendo de la combinación de colores de los Leds informa si el Data Logger no está activado, si está activado correctamente, si ha registrado una alarma, si está parado correctamente o si está fuera de límites de alarma

Número de serie

Consideraciones previas

Usted ha adquirido un Data Logger de un solo uso que está configurado para realizar registros de temperaturas a los intervalos y durante el periodo de tiempo definido en su configuración; tenga en cuenta que este Data Logger ofrece dos funciones adicionales muy interesantes y que pueden resultarles muy prácticas:

1- Aunque el Data Logger tiene una configuración predefinida, cualquier usuario puede cambiar los parámetros de la configuración para adaptarlo a ciertas necesidades específicas; para poder hacerlo debe conectarse el Data Logger al ordenador antes de activarlo y usar el Software correspondiente. Le recordamos que sería necesario utilizar la bolsita de plástico que también se suministra para asegurar su estanqueidad y protección contra el polvo y el agua.

2- Este Data Logger le permite comprobar y descargar la información en cualquier momento, para utilizar esta función el **Data Logger NO DEBE PARARSE**, debe conectarlo al puerto USB de su ordenador y se generará una carpeta con dos ficheros, un informe PDF (gráfico y tabular) y un fichero CSV que Usted podrá guardar como considere; hay que tener en cuenta que mientras el Data Logger esté conectado al ordenador no registrará ninguna lectura, una vez desconecte el Data Logger del puerto USB, seguirá registrando de forma normal y en base a los parámetros de configuración que tenga establecidos, podrá repetir esta función tantas veces como Usted considere; recomendamos el uso de la bolsita de plástico que se suministra con el Data Logger para asegurar su estanqueidad y protección contra el polvo y el agua.

Poner en marcha e iniciar la grabación

- 1- presione el botón START  durante 5 segundos.
- 2- al dejar de presionar, el indicador LED  parpadeará 5 veces indicando el correcto inicio de la grabación.
- 3- si es necesario retire la etiqueta adhesiva  con el número de serie y enganchela en la documentación de expedición como referencia para identificar su trazabilidad.

Comprobar el estado del Data Logger en cualquier momento

Presione 1 vez el Botón START / STATUS 

si parpadean 1 vez y simultáneamente los indicadores LED  +  indica que el Data Logger está parado y que todavía no se ha puesto en marcha

si parpadea 1 vez el indicador LED  indica que el Data Logger está en marcha

si parpadea 1 vez el indicador LED  indica que el Data Logger está en marcha y que ha sobrepasado alguna alarma

si parpadea 2 veces el indicador LED  indica que hemos parado correctamente el Data Logger

si parpadea 2 veces el indicador LED  indica que el Data Logger está parado y que en algún momento del registro ha existido una alarma.

Crear una marca durante el registro en cualquier momento

- 1- presione el botón MARK  2 veces rapidamente
- 2- al dejar de presionar, los indicadores LED  +  parpadearán simultaneamente 5 veces indicando el correcto establecimiento de la marca.

Parar o detener la grabación

- 1- presione el botón START  durante 5 segundos.
- 2- al dejar de presionar, el indicador LED  parpadeará 5 veces indicando la correcta parada de la grabación.

Conectar el Data Logger al puerto USB

- 1- rompa el precinto o cubierta impermeable por la zona que está indica a la altura del puerto USB.
- 2- conecte el Data Logger al puerto USB de su ordenador, cuando se conecta por primera vez los dos LED  +  parpadearán simultáneamente para indicar que el informe PDF se está generando; no desconecte el registrador hasta que ambos LED estén con la luz fija.